


設置する

設置方法


離床センサーはベッドや布団のマットレスの下に設置してください。
離床センサーの電源中継プラグと AC アダプタを接続してください。

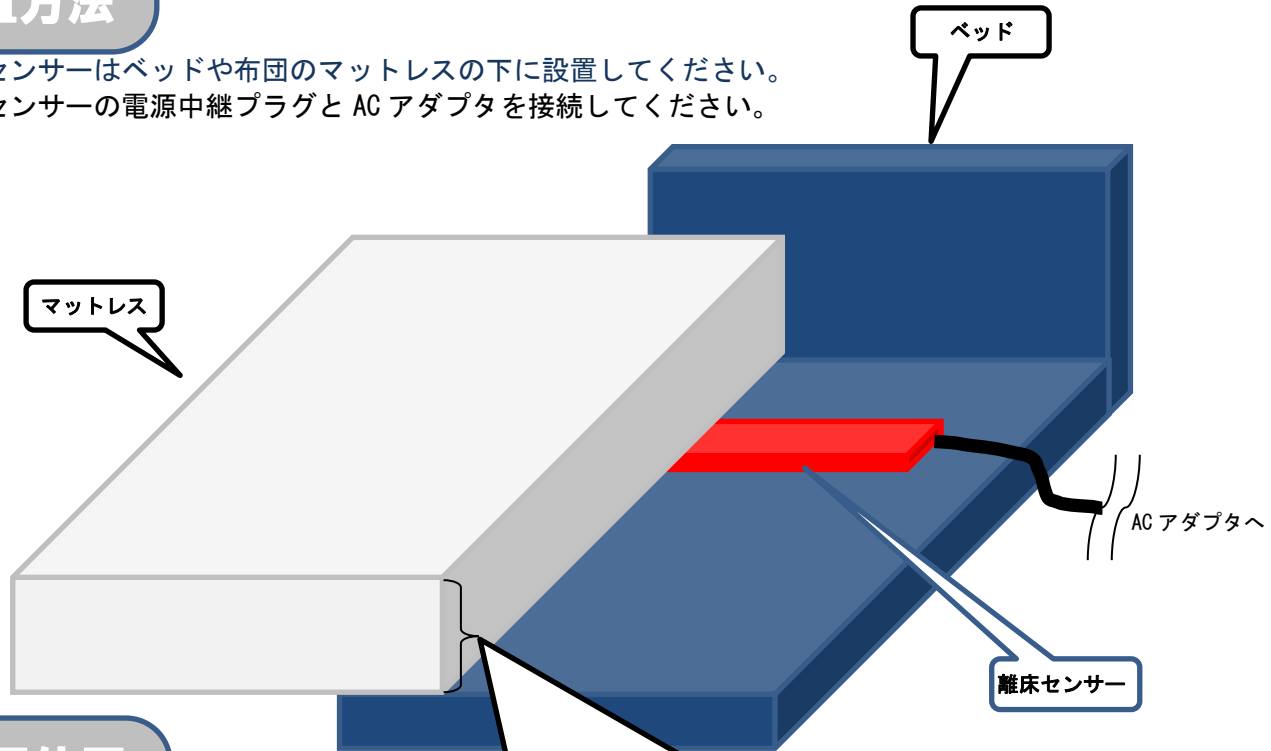


設置位置

マットの厚さ 10cm~30cm 位まで対応可能
(ウォーターベッド、一部のスプリングマット等のご利用になれない場合があります。)

離床センサーが胸またはお腹の下に来るように設置してください。

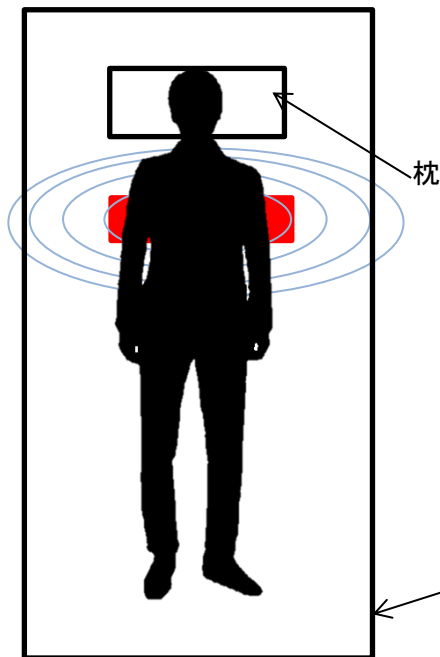

上から見た図

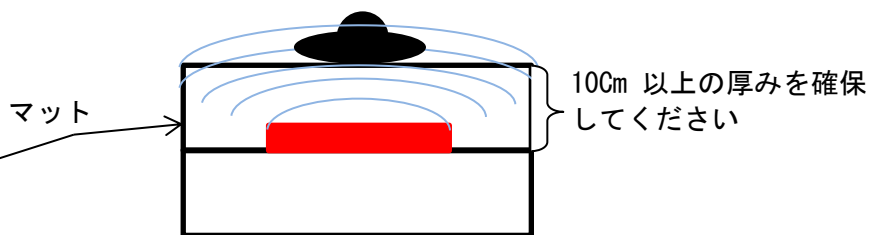

横から見た図

★注意

介護用ベッドや医療用ベッドは別途ご相談ください。